


FOTO-Verfahren zum Austausch des Brilix-Displaygehäuses - Ersatz-Touchscreen - Hidrolife / Oxilife - 1BP02-04-002

1) Zwei Anzeigearten



2) Die hintere Abdeckung wird mit einem Schraubendreher entfernt.

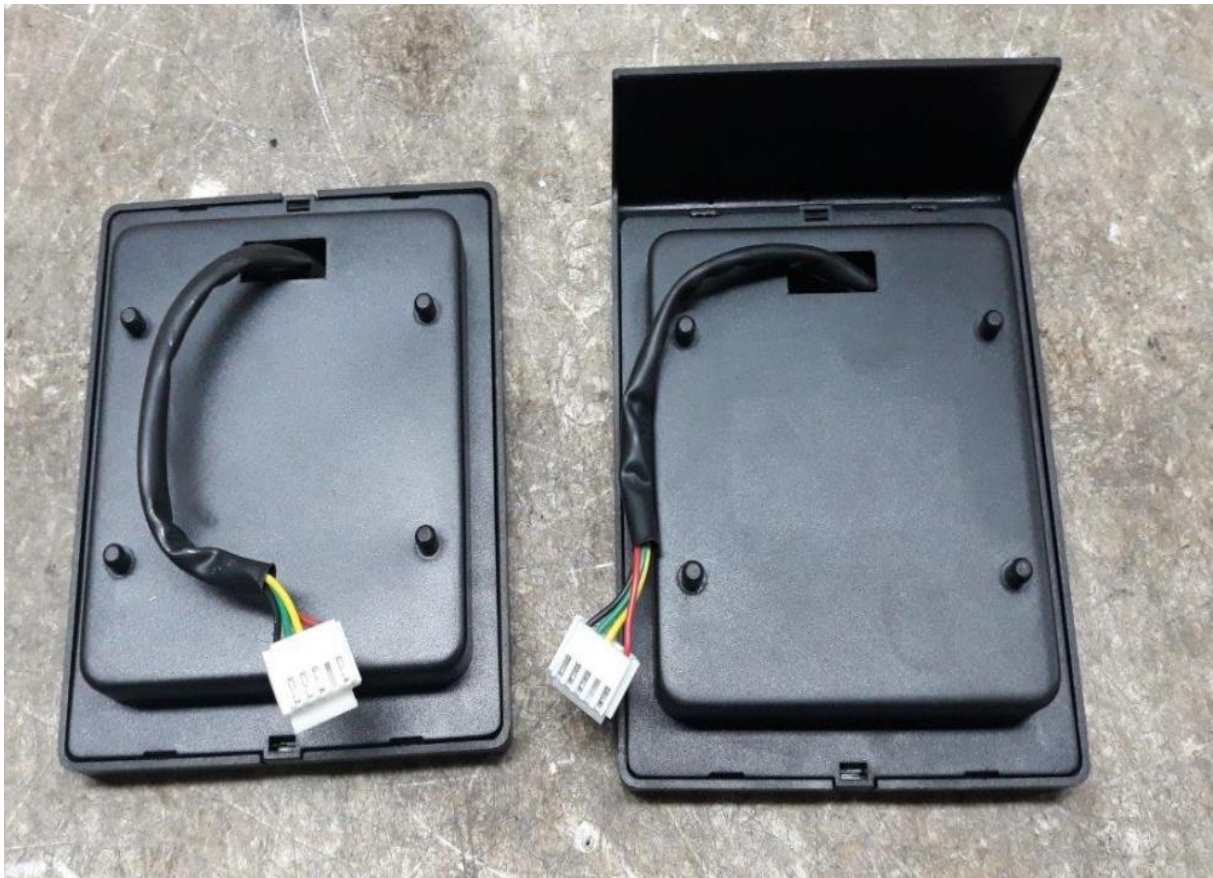

- 3) Nehmen Sie das Display mit einem Schraubendreher aus der Verpackung und legen Sie es in die passende Hülle.



4) Bringen Sie die Abdeckungen wieder an und legen Sie die richtige Anzeige in den Salzstreuer.

